

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – Divulgação Eletrônica

Aviso de Resultados

A Associação Dr. Bartholomeu Tacchini comunica o resultado da Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº 1.852549/2018 para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes no âmbito do Convênio MS nº 852549/2017, das empresas participantes e seus respectivos itens, conforme abaixo:

Fornecedores/ Equipamento:	<p>Item 1: Aquecedor de Fluidos /Sangue</p> <p>Empresa 1: NewMed Produtos para Saúde Ltda. Considerando: 1) Não atende capacidade interna mínima; 2) Não informa atender capacidade interna mínima de 100l. <i>Desclassificada tecnicamente.</i> Ação: realizar nova Cotação Prévia de Preços_Divulgação Eletrônica.</p>
	<p>Item 2: Lavadora Termodesinfectora</p> <p>Empresa 1: BAUMER S/A. Vencedora.</p>
	<p>Item 3: Ventilador Pulmonar Pressométrico</p> <p>Empresa 1: MAQUET do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Vencedora. Empresa 2: Medical Sul Equipamentos Médicos Ltda. Considerando: 1) Não atende ajuste da pressão controlada na faixa de 1 a 90 cmH2O ou maior; 2) Ventilação mandatória intermitente sincronizada com volume controlado e pressão regulada ciclado a tempo. <i>Desclassificada tecnicamente.</i> Empresa 3: Leistung Equipamentos Ltda Considerando: 1) Não atende ajuste da pressão controlada na faixa de 1 a 90 cmH2o ou maior (acima da Peep); 2) Sistema de disparo em resposta esforço do paciente deve operar nos modos sensível a pressão e/ou fluxo na faixa igual ou menor que – 20 cm H2O até – 1 cmH2O. <i>Desclassificada tecnicamente.</i></p>
	<p>Item 4: Monitor Multiparamétricos</p> <p>Empresa 1: Alfa Med Sistemas Médicos Ltda Considerando: 1) Não atende faixa de medição de frequência Cardíaca de 0 a 350bpm; 2) Não atende faixa de leitura de PI de -50 a 400mmHg. <i>Desclassificada tecnicamente.</i> Empresa 2: Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda. Vencedora. Empresa 3: Hospitrade Distribuidora de Equipamento Hospitalar Ltda, Considerando: 1) Não indica faixas de leitura de PMI ECG e Saturação; 2) No catálogo enviado faltam informações das características do produto; 3) Não atende ao item C do edital. <i>Desclassificada tecnicamente.</i> Empresa 4: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. Valor acima do aprovada.</p>

Assim, ficam as empresas intimadas do prazo recursal, conforme artigo 109 da Lei nº 9.666/93. Caso não haja interposição de recurso e-mail: propostas@tacchini.com.br ou (54) 3455 4142 ou 3455 4169, estabelece-se o dia 28.11.2018 para a homologação do resultado do julgamento das propostas de preço. Cabe ressaltar a observância da Portaria Interministerial 424/2016.

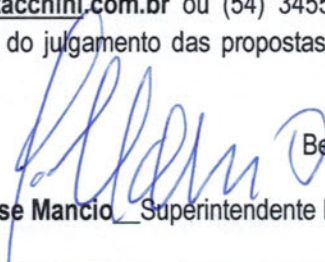

Bento Gonçalves/RS, 21 de novembro de 2018.

Hilton Roesse Mancio, Superintendente Executivo

Laudo Técnico referente ao Convênio 852549/2017**Cotação prévia de preços – divulgação eletrônica nº1.852549-2018****Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA RS sob o nº 9940147****Item 1 – Equipamento Aquecedor de fluídos/sangue****Empresa 1:** Newmed produtos para saúde Ltda**Descrição:** Sistema de aquecimento de sangue e fluídos, modelo 04-980121EU, fabricante Carefusion.**Justificativa:** Não atende o edital referente a capacidade interna mínima de 100 litros; Câmara internamente em material não ferroso e externamente em chapa de aço tratada e pintada com tinta epóxi, ou eletrostática branca. Porta fechada com guarnição de PVC em todo o perímetro, permitindo uma isolamento térmica em todas as paredes, inclusive na porta. Portas individuais em acrílicos transparentes para cada prateleira para evitar perdas de temperatura no momento da abertura da porta. Sistema de refrigeração livre CFC. Unidade de refrigeração selada, com silencioso compressor para funcionamento contínuo, montado sobre coxins para a transmissão de vibrações e sistema que evita acúmulo de gelo, sem a necessidade de realizar o sistema de degelo periodicamente. Circulação de ar forçado para proporcionar uma perfeita homogeneidade dentro da câmara e sem provocar vibrações. Painel de controle frontal, superior, em display em LCD, com teclas que permita acesso a todas as funções. Indicação visual e simultânea no display da temperatura do momento, hora e temperatura máxima e mínima.**Item 3 – Ventilador pulmonar pressométrico****Empresa 2:** Medical Sul Equipamentos Médicos Ltda**Descrição:** Ventilador Pulmonar Pressométrico modelo IX5**Justificativa:** Considerando, não atender: 1) Ajuste da Pressão Controlada (PC) na faixa de 1 a 90 cmH₂O ou maior (Acima da PEEP); 2) Ventilação mandatória intermitente sincronizada com volume controlado e pressão regulada ciclado a tempo**Empresa 3:** Leistung Equipamentos Ltda**Descrição:** Ventilador Pulmonar Pressométrico modelo Luft3*Carry*

Justificativa: Não atende o edital referente a ajuste da pressão controlada na faixa de 1 a 90 cmH₂O ou maior (acima da Peep) e sistema de disparo em resposta esforço do paciente deve operar nos modos sensível a pressão e/ou fluxo na faixa igual ou menor que - 20 cm H₂O até - 1 cmH₂O.

Item 4 – Equipamento Monitor Multiparâmetros

Empresa 1: Alfamed Sistemas Médicos Ltda

Descrição: Monitor multiparamétrico modelo Vita1100, marca Alfa Med

Justificativa: Não atende faixa de medição de frequência Cardíaca de 0 a 350bpm e faixa de leitura de PI de -50 a 400mmHg

Empresa 3: Hospitrade Distribuidora de Equipamento Hospitalar Ltda

Descrição: Monitor Multiparamétrico modelo RD12, marca RD Mediq

Justificativa: Não indica faixas de leitura de PMI ECG e Saturação; No catálogo enviado faltam informações das características do produto; Não atende ao item 5.3C do edital.(.. Ficará a licitante obrigada a treinar os profissionais da Associação Dr. Bartholomeu Tacchini, sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição, na manutenção do(s) equipamento(s), para até 02(dois) funcionários técnicos....)

Bento Gonçalves, 30 de Outubro de 2018.

Carlos Augusto Mattoso Pereira
Carlos Augusto M. Pereira
Eng. Eletricista
RS199536